


Riferimento rapido per la prolunga per incubatrice

HAMILTON-HF90


REF 10108298 Prolunga per incubatrice, 0,33 m, non riscaldata, pazienti neonatali

Da utilizzare con i set circuito paziente neonatali/pediatrici PN 10103261 e PN 10119946

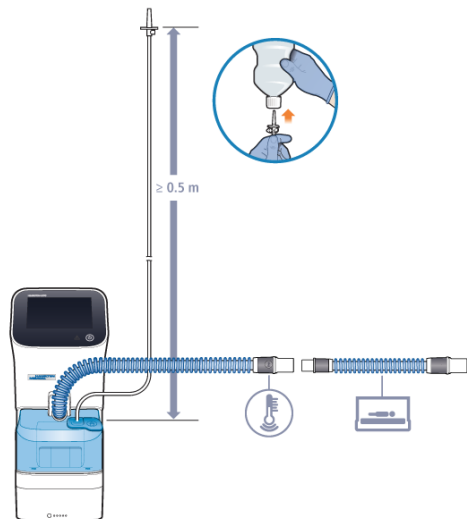

Vedere le Istruzioni per l'uso,
PN 10112976

Configurazione per incubatrice

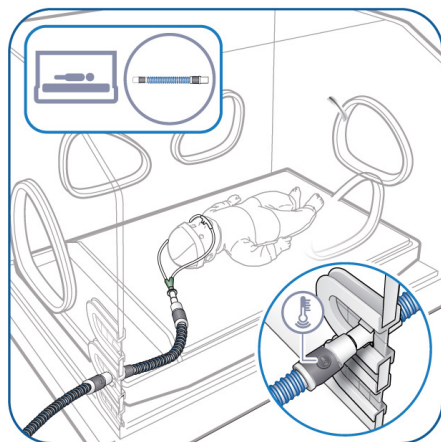

Configurazione per letto riscaldante

